



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 720 – 2546

ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว

BLOOD TRANSFUSION SETS FOR SINGLE – USE

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 11.040.20

ISBN 974-608-764-9

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(กรมวิทยาศาสตร์)

กรมวิทยาศาสตร์
ถนนจรัญ ๑๕๕๕.๒๕

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมเวช

โรงพยาบาล กรมการแพทย์
ถนนวิเศษไชยชาญ

รพ.ศิริราชพยาบาล กรมการแพทย์

แอมบิวลา กรมการแพทย์

มอก. 720-2546

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

โรงพยาบาล กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

อธิบดี (กรมการแพทย์) กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

อธิบดี กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนที่ 31ง
วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2547

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว นี้ ได้ประกาศใช้ครั้งแรกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดสำหรับให้เลือด มาตรฐานเลขที่ มอก. 720-2536 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 64 วันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536

ต่อมาได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน จึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและ กำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นใหม่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในประเทศและเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

AS 2385-1990	Single-use (sterile) infusion sets for general medical use
ISO 1135-4 : 1998	Transfusion equipment for medical use- Part 4 : Transfusion sets for single use
ISO 10993-5 : 1999	Biological evaluation of medical devices - Part 5 : Tests for in vitro cytotoxicity
ASTM F 756-93	Standard Practice for Assessment of Hemolytic Properties of Materials
มอก.1287-2538	น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
The United States Pharmacopeia, 25 Revision, 2002	

ภาคผนวก ก. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินกำหนดไว้เป็นเพียงข้อแนะนำ

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 3220 (พ.ศ. 2547)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชุดสำหรับให้เลือด

และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดสำหรับให้เลือด มาตรฐานเลขที่ มอก.720-2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1874 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดสำหรับให้เลือด ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2536 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 720-2546 ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

พินิจ จารุสมบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว

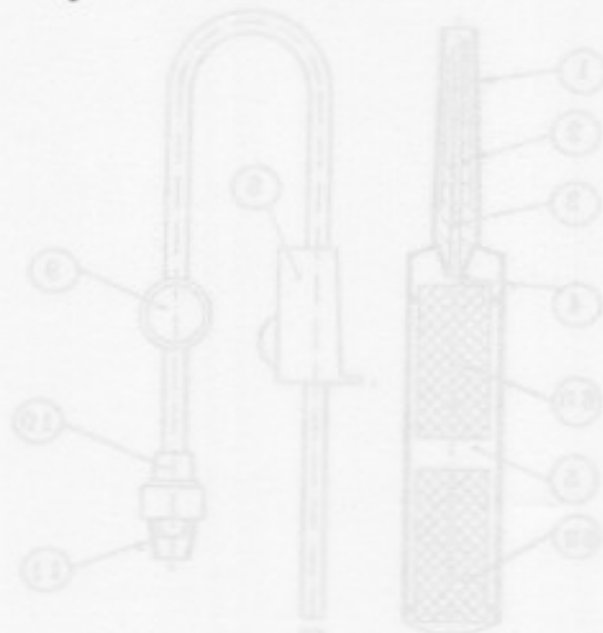

1. ขอบข่าย


- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงชุดให้เลือดที่ใช้งานเพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปมีส่วนประกอบตามรูปที่ 1 และอาจมีอุปกรณ์ให้อากาศเข้าตามรูปที่ 2 ด้วยหรือไม่ก็ได้

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว (blood transfusion sets for single use) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ชุดให้เลือด” หมายถึง อุปกรณ์ที่นำเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด (พลาสมา เกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง) จากภาชนะบรรจุเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือด
- 2.2 อุปกรณ์ให้อากาศเข้า (air-inlet device) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับกรองอากาศเข้าไปในภาชนะบรรจุเลือด ซึ่งต้องมีตัวกรองอากาศเพื่อกรองจุลินทรีย์


เครื่องทดสอบการไหลของเลือด
ชนิดใช้เข็มฉีดยา

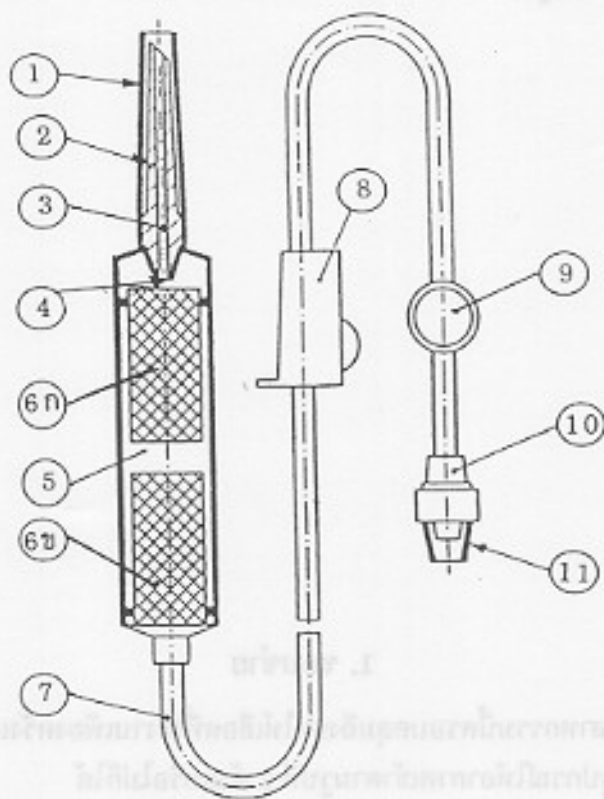

รูปที่ 1

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ① | ปลอกหุ้มเข็มเจาะภาชนะบรรจุ | ⑦ | สายส่ง |
| ② | เข็มเจาะภาชนะบรรจุ | ⑧ | ตัวควบคุมการไหล |
| ③ | รูเข็มเจาะภาชนะบรรจุ | ⑨ | บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑ์เภสัช (มีหรือไม่มีก็ได้) |
| ④ | ท้อหยุด | ⑩ | ข้อต่อโน |
| ⑤ | กระเปาะหยุด | ⑪ | ปลอกหุ้มข้อต่อโน |
| ⑥ | ตัวกรองเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด
(อาจอยู่ที่ตำแหน่ง ก หรือ ข ก็ได้) | | |

รูปที่ 1 ตัวอย่างส่วนประกอบโดยทั่วไปของชุดให้เลือด
(ข้อ 1.1)

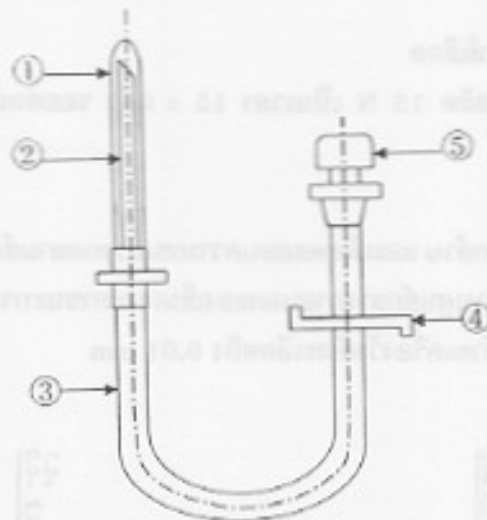

- ① ปลอกหุ้มเชื่อมอากาศ
 ② เส้นอากาศ
 ③ ท่ออากาศ (เข้ามี)
 ④ ที่ยึดท่ออากาศ (เฉพาะกรณีที่มีท่ออากาศ)
 ⑤ ตัวกรองอากาศ

รูปที่ 2 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ท่ออากาศเข้า

(ข้อ 1.1)

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

ชุดให้เลือดต้องสะอาด และไม่มีตำหนิที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน การทดสอบให้ตรงพินิจ

3.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์

3.2.1 อนุภาคปนเปื้อน


ชุดให้เลือดต้องไม่มีอนุภาคปนเปื้อนมาก โดยเมื่อทดสอบตามข้อ 7.1 แล้ว อาจมีอนุภาคปนเปื้อนขนาดต่างๆ ได้ดังนี้

- (1) ขนาดใหญ่กว่า 25 μm ถึง 50 μm มีได้ไม่เกิน 100 อนุภาค
- (2) ขนาดใหญ่กว่า 50 μm ถึง 100 μm มีได้ไม่เกิน 20 อนุภาค
- (3) ต้องไม่มีอนุภาคปนเปื้อนขนาดใหญ่กว่า 100 ไมโครเมตร

3.2.2 การรั่วซึม

เมื่อทดสอบตามข้อ 7.2 แล้ว ต้องไม่ปรากฏฟองอากาศ

- 3.2.3 รอยต่อเชื่อมภายในชุดให้เลือด
เมื่อทดสอบด้วยแรงดึงสถิต 15 N เป็นเวลา 15 s แล้ว รอยต่อเชื่อมภายในชุดให้เลือดทุกตำแหน่ง
ต้องไม่หลุด
- 3.2.4 เข็มเจาะภาชนะบรรจุ
 - 3.2.4.1 ต้องทำด้วยพลาสติกล้วน และเมื่อทดสอบความทนแรงกดตามข้อ 7.3 แล้ว ต้องไม่หัก แตก หรือร้าว
 - 3.2.4.2 ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเข็มเจาะภาชนะบรรจุ ให้เป็นไปตามรูปที่ 3
การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.01 mm

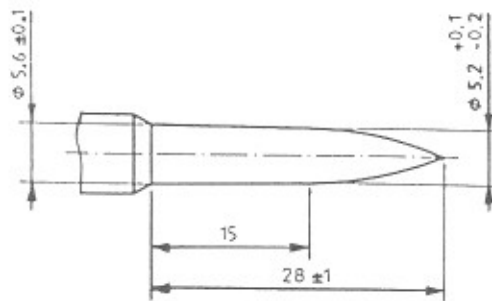

หน่วยเป็น mm

รูปที่ 3 ตัวอย่างเข็มเจาะภาชนะบรรจุ
(ข้อ 3.2.4.2)

- 3.2.5 อุปกรณ์ให้อากาศเข้า (ถ้ามี)
 - 3.2.5.1 อุปกรณ์ให้อากาศเข้าต้องมีตัวกรองอากาศ
การทดสอบให้ตรวจพินิจ
 - 3.2.5.2 เข็มอากาศต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 0.75 mm และที่ปลายเปิดด้านสัมผัสกับอากาศ
ต้องมีตัวกรองอากาศ
การทดสอบให้ตรวจพินิจและวัดด้วยเครื่องวัดที่เหมาะสม
 - 3.2.5.3 อัตราการไหลของน้ำเมื่อมีและเมื่อไม่มีตัวกรองอากาศ
เมื่อทดสอบตามข้อ 7.4 แล้ว อัตราการไหลของน้ำเมื่อมีตัวกรองอากาศจะลดลงได้ไม่เกิน 20%
ของอัตราการไหลของน้ำเมื่อไม่มีตัวกรองอากาศ
- 3.2.6 สายส่ง
 - 3.2.6.1 สายส่งต้องทำจากวัสดุที่โค้งงอได้ (flexible) มีสีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ทำ โปร่งใสหรือโปร่งแสง
เพียงพอที่จะมองเห็นฟองอากาศที่อาจเกิดในเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่อยู่ภายในได้
การทดสอบให้ตรวจพินิจ
 - 3.2.6.2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต้องไม่น้อยกว่า 2.7 mm
การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.05 mm

- 3.2.6.3 ความยาวเมื่อวัดจากปลายข้อต่อในถึงกระเปาะหยดต้องไม่น้อยกว่า 150 cm
การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดที่ละเอียดถึง 1 mm
- 3.2.7 ตัวกรองเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด
- 3.2.7.1 ต้องมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 32 cm²
- 3.2.7.2 ต้องมีพื้นที่ของรูเปิดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10 cm²
- 3.2.7.3 ขนาดของรูเปิดต้องสม่ำเสมอและมีเส้นทแยงมุมยาวไม่เกิน 0.28 mm
- 3.2.7.4 เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย (filament) ต้องไม่น้อยกว่า 0.1 mm
การทดสอบสำหรับข้อ 3.2.7.1 ให้วัดและคำนวณ สำหรับข้อ 3.2.7.2 ข้อ 3.2.7.3 และข้อ 3.2.7.4 ให้ใช้เครื่องส่องขยาย (profile projector) ที่มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 10 เท่า
- 3.2.8 กระเปาะหยด
ต้องทำด้วยพลาสติกอ่อนที่สามารถบีบป้อนเลือดได้ มีสีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ทำ และเป็นแบบหรือรูปร่างที่สามารถสังเกตเห็นการหยดของเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดได้ชัด ท่อหยดต้องมีลักษณะดังนี้
- 3.2.8.1 ระยะระหว่างปลายท่อหยดกับปากทางออกของกระเปาะหยด ต้องไม่น้อยกว่า 40 mm
การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.5 mm
- 3.2.8.2 ระยะระหว่างผนังด้านนอกของส่วนปลายของท่อหยดกับผนังด้านในของกระเปาะหยด ต้องไม่น้อยกว่า 5 mm
การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.05 mm
- 3.2.8.3 เมื่อทดสอบตามข้อ 7.5 แล้ว น้ำกลั่นที่ไหลผ่านท่อหยดตามจำนวนหยดที่ระบุไว้ที่ฉลาก ต้องมีปริมาณ $1 \text{ cm}^3 \pm 0.1 \text{ cm}^3$ หรือ $1 \text{ g} \pm 0.1 \text{ g}$
- 3.2.9 ตัวควบคุมการไหล
ต้องสามารถปรับอัตราการไหลได้ตามต้องการ ต้องหยุดการไหลได้สนิทเมื่ออยู่ในตำแหน่งปิด และไม่ทำให้สายส่งเสียหายต่อการใช้งาน เช่น รั่ว หรือตีบ
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.6
- 3.2.10 อัตราการไหล
เมื่อทดสอบตามข้อ 7.6 แล้ว ระยะเวลาที่น้ำกลั่นไหลผ่านชุดให้เลือดครบ 500 cm³ ต้องไม่เกิน 2.5 min
- 3.2.11 บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑ์เกล็ด (เฉพาะกรณีที่ใช้แทงด้วยเข็มฉีดยา)
เมื่อทดสอบตามข้อ 7.7 แล้ว ยอมให้น้ำซึมออกมาได้ไม่เกิน 1 หยด
- 3.2.12 ข้อต่อใน
- 3.2.12.1 กรณีไม่มีเข็มแทงเข้าเส้นเลือด หรือมีแต่ไม่ได้ต่อกับข้อต่อใน ต้องมีปลอกหุ้มซึ่งสวมได้พอดีกับข้อต่อใน และสามารถเอาออกได้ง่ายโดยการบิดเล็กน้อยแล้วดึงออก
การทดสอบให้ตรวจพินิจ
- 3.2.12.2 เมื่อทดสอบตามข้อ 7.8 แล้ว ด้านปลายเล็กของข้อต่อในต้องอยู่ระหว่างระนาบ A และระนาบ B ของเครื่องมือวัด

- 3.2.13 ปลอกหุ้มเข็มเจาะภาชนะบรรจุ
ต้องหุ้มตลอดความยาวของตัวเข็ม สวมได้พอดีกับด้ามเข็ม และสามารถเอาออกได้ง่ายโดยการบิดเล็กน้อย แล้วดึงออก
การทดสอบให้ตรวจพินิจ
- 3.2.14 ความทนอุณหภูมิสูง
เมื่อนำชุดให้เลือดไปไว้ในตู้อบที่อุณหภูมิ $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2 h และนำมาทดสอบการรั่วซึมตามข้อ 7.2 แล้ว ต้องไม่ปรากฏฟองอากาศ
- 3.3 คุณลักษณะทางเคมี
เมื่อทดสอบตามข้อ 7.9 แล้ว สารละลายที่สกัดได้ต้องมีสมบัติดังนี้
 - 3.3.1 ลักษณะทั่วไป
ใส ไม่มีสี
 - 3.3.2 สารรีดิวซ์ (reducing or oxidizable matter)
ปริมาณสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 0.002 mol/l ที่ใช้ทำปฏิกิริยาต้องไม่เกิน 2.0 cm^3
 - 3.3.3 ปริมาณโลหะ
ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 - 3.3.3.1 ปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และดีบุก รวมกันต้องไม่เกิน $1 \mu\text{g}$ ต่อสารละลายที่สกัดได้ 1 cm^3
ปริมาณแคดเมียม ต้องไม่เกิน $0.1 \mu\text{g}$ ต่อสารละลายที่สกัดได้ 1 cm^3
 - 3.3.3.2 ปริมาณโลหะ (เทียบเป็นตะกั่ว) ต้องไม่เกิน $1 \mu\text{g}$ ต่อสารละลายที่สกัดได้ 1 cm^3
 - 3.3.4 ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง
ปริมาณสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ไทเทรตจนทำให้สีของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนเป็นสีเทาต้องไม่เกิน 1 cm^3
 - 3.3.5 ปริมาณกากที่ไม่ระเหย (non-volatile residue)
ต้องไม่เกิน 5 mg
 - 3.3.6 การดูดกลืนแสง
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นใด ๆ ระหว่าง 250 nm ถึง 320 nm ต้องไม่เกิน 0.1
- 3.4 คุณลักษณะทางชีวภาพ
 - 3.4.1 ความปราศจากเชื้อ
ต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม USP 25 หัวข้อ Sterility Tests
หมายเหตุ ในกรณีที่มีอุปกรณ์ให้อากาศเข้ารวมมาในชุดเดียวกันให้นำอุปกรณ์ให้อากาศเข้ามาทดสอบความปราศจากเชื้อพร้อมกับชุดให้เลือดด้วย

3.4.2 สารไฟโรเจน

ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ไม่มีสารไฟโรเจน หรือ
- (2) ถือว่าไม่มีสารไฟโรเจน เมื่อระดับเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ไม่เกิน 20.0 หน่วยเอ็นโดท็อกซินต่อซุต

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7.10

3.4.3 การทำลายเม็ดเลือด

เมื่อทดสอบตามข้อ 7.11 แล้ว ต้องไม่มีการแตกตัวของเม็ดเลือด โดยค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด (haemolytic index) ต้องน้อยกว่า 2

3.4.4 ความเป็นพิษ

ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง หรือ
- (2) ไม่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง

การทดสอบให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ข.

4. การบรรจุ

- 4.1 ให้บรรจุชุดให้เลือดแต่ละชุดในภาชนะหุ้มห่อที่ฉีกเรียบร้อย สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาการเก็บ และผลิตภัณฑ์ต้องไม่แบน ไม่หักพับ ปลอดหุ้มเข็มเจาะภาชนะบรรจุ ข้อต่อในและ/หรือ เข็มแทงเข้าเส้นเลือดต้องไม่หลุด

5. เครื่องหมายและฉลาก

- 5.1 ที่ภาชนะหุ้มห่อชุดให้เลือดทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
ในกรณีที่มีเข็มแทงเข้าเส้นเลือดและอุปกรณ์ให้อากาศเข้า ให้ระบุข้อความว่า “พร้อมเข็มแทงเข้าเส้นเลือดและอุปกรณ์ให้อากาศเข้า”
ในกรณีที่มีเฉพาะเข็มแทงเข้าเส้นเลือด ให้ระบุข้อความว่า “พร้อมเข็มแทงเข้าเส้นเลือด”
ในกรณีที่มีเฉพาะอุปกรณ์ให้อากาศเข้า ให้ระบุข้อความว่า “พร้อมอุปกรณ์ให้อากาศเข้า”
 - (2) คำว่า “ปราศจากเชื้อ” และ “ปราศจากสารไฟโรเจน” และ “ใช้ได้ครั้งเดียว”
 - (3) ขนาดระบุ และความยาว ของเข็มแทงเข้าเส้นเลือด (ถ้ามี) เป็น G และ mm ตามลำดับ
หมายเหตุ ขนาดระบุเป็น G ตาม มอก.1398
 - (4) จำนวนหยดต่อ 1 cm^3 ได้แก่ 15 หยดต่อ 1 cm^3 20 หยดต่อ 1 cm^3
 - (5) วิธีทำให้ปราศจากเชื้อ
 - (6) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ

(7) เดือน ปีที่หมดอายุ

(8) วิธีใช้

(9) คำเตือนหรือข้อควรระวังในการใช้และการทำลาย เช่น ห้ามใช้เมื่อภาชนะหุ้มห่อชำรุด ควรแยกทำลายแบบขยะติดเชื้อ

(10) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

5.2 ที่กล่องใหญ่ที่บรรจุชุดให้เลือดทุกกล่อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดตามข้อ 5.1(1) ข้อ 5.1(2) ข้อ 5.1(6) ข้อ 5.1(7) ข้อ 5.1(10) จำนวนบรรจุเป็นชุด และวิธีเก็บรักษา ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

5.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ

7.1 อนุภาคปนเปื้อน

7.1.1 ภาวะทดสอบ

ให้ทดสอบภายในตู้ลามินาร์แอร์โฟลว์ (laminar airflow hood) ซึ่งจะมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ $0.5 \mu\text{m}$ ไม่เกิน 3 530 อนุภาคต่อ 1 cm^3 class 100 ตาม US Federal Standard 209E หรือ class N2 ตาม ISO 14644-1 และผู้ทดสอบควรสวมเสื้อผ้าที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อยที่สุดและสวมถุงมือยางที่ปราศจากแป้ง

7.1.2 เครื่องมือ

7.1.2.1 แผ่นกรอง ขนาดรูเปิดไม่เกิน $1.2 \mu\text{m}$

7.1.2.2 กระจกฉีดยาทำด้วยแก้ว ขนาดบรรจุ 50 cm^3 พร้อมเข็มฉีดยา ขนาดตามความเหมาะสมที่สามารถแทงเข้าไปในรูของเข็มเจาะภาชนะบรรจุได้

7.1.2.3 ขวดแก้วรูปกรวยที่สะอาด

7.1.2.4 แผ่นกรองแบบมีตารางสี่เหลี่ยมหรือสี่ตา (gridded membrane filter) ที่เหมาะสม ขนาดรูเปิด $0.8 \mu\text{m}$

7.1.2.5 กล้องจุลทรรศน์ ที่มีกำลังขยาย 50 เท่า มีไฟส่องสว่างที่เหมาะสม มุมตกกระทบกับแท่นวางสไลด์ระหว่าง 0° ถึง 10°

7.1.3 สารละลาย และวิธีเตรียม

7.1.3.1 น้ำ ชั้นคุณภาพ 1 หรือชั้นคุณภาพ 2 ตาม มอก.1287

7.1.3.2 สารละลายทดสอบ

ละลายโซเดียม เอ็น-เมทิล-เอ็น-โอเลอิล ทอเรต 3 g ในน้ำ (ข้อ 7.1.3.1) 10 l แล้วกรองผ่านแผ่นกรองโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ (vacuum suction)

7.1.4 วิธีทดสอบ

7.1.4.1 การเตรียมแบลงก์

(1) ใช้กระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาดูดสารละลายทดสอบ (ข้อ 7.1.3.2) 50 cm³ ฉีดลงในขวดแก้วรูปกรวย บันทึกเวลาที่ใช้ฉีดสารละลายทดสอบจนหมด 50 cm³ ไว้ แล้วนำสารละลายที่ได้ไป

กรองผ่านแผ่นกรองแบบมีตาราง (2) ปฏิบัติตามข้อ (1) อีกครั้งหนึ่ง โดยกรองผ่านแผ่นกรองแบบมีตารางแผ่นใหม่

7.1.4.2 นับจำนวนอนุภาคบนแผ่นกรองแบบมีตารางทั้ง 2 แผ่น ผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยแบ่งประเภทอนุภาค

ป็นเงื่อนไขขนาดที่ยาวที่สุดของอนุภาค (d) เป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 (class I) : 25 μm < d ≤ 50 μm

ระดับที่ 2 (class II) : 50 μm < d ≤ 100 μm

ระดับที่ 3 (class III) : 100 μm < d

แล้วทดสอบต่อ เมื่อผลการนับจำนวนอนุภาคของแบลงก์เป็นดังนี้

ระดับที่ 1 ไม่เกิน 5 อนุภาค

ระดับที่ 2 ไม่เกิน 1 อนุภาค

ระดับที่ 3 ไม่ปรากฏ

7.1.4.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ

(1) ใช้กระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาดูดสารละลายทดสอบ (ข้อ 7.1.3.2) 50 cm³ แหงเข็มฉีดยาเข้าไปในรูเข็มเจาะภาชนะบรรจุของชุดให้เลือดตัวอย่าง ส่วนปลายด้านข้อต่อในให้รอดด้วยขวดแก้วรูปกรวย ฉีดสารละลายทดสอบทั้ง 50 cm³ ผ่านชุดให้เลือดตัวอย่างลงสู่ขวดแก้วรูปกรวยด้วยเวลาที่บันทึกไว้ตามข้อ 7.1.4.1(1) แล้วนำสารละลายที่ได้ไปกรองผ่านแผ่นกรองแบบมีตาราง

(2) ใช้กระบอกฉีดยาอันเต็ม ปฏิบัติตามข้อ (1) อีกครั้งหนึ่ง โดยกรองผ่านแผ่นกรองแบบมีตารางแผ่นใหม่

7.1.4.4 นับจำนวนอนุภาคบนแผ่นกรองแบบมีตารางทั้ง 2 แผ่น ผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยแบ่งประเภทอนุภาค

ป็นเงื่อนไขขนาดที่ยาวที่สุดของอนุภาค (d) เป็น 3 ระดับ ตามข้อ 7.1.4.2

7.1.5 การรายงานผล

7.1.5.1 ให้รายงานจำนวนอนุภาคที่พบ โดยแยกเป็นแต่ละระดับ

7.1.5.2 ให้ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในเอกสารรายงานผลการทดสอบ

(1) อัตราการไหลเฉลี่ยของสารละลายทดสอบขณะไหลผ่านชุดให้เลือดตัวอย่าง

(2) ปริมาณอนุภาคที่พบทั้งหมด

(3) ปริมาณอนุภาคที่พบในแต่ละระดับ พร้อมทั้งผลการนับปริมาณอนุภาคของแบลงก์ อย่างน้อย

1 ครั้ง

7.2 การรื้อชิ้น

7.2.1 เครื่องมือ

7.2.1.1 เครื่องอัดอากาศที่สามารถอัดอากาศให้ได้ความดันไม่น้อยกว่า 50 kPa

7.2.1.2 อ่างน้ำที่บรรจุน้ำที่มีอุณหภูมิระหว่าง 20°C ถึง 30°C

7.2.1.3 อุปกรณ์สำหรับปิดปลายด้านข้อต่อในที่เหมาะสม

7.2.2 วิธีทดสอบ

ต่อปลายด้านเข็มเจาะภาชนะบรรจุของชุดให้เลือดตัวอย่างเข้ากับเครื่องอัดอากาศ ปิดปลายอีกด้านหนึ่งไว้ แล้วจุ่มลงในอ่างน้ำ อัดอากาศเข้าไปในชุดให้เลือดตัวอย่าง จนความดันภายในเป็น 50 kPa เป็นเวลา 2 min สังเกตว่ามีฟองอากาศหรือไม่

7.3 ความทนแรงกด

ยึดเข็มเจาะภาชนะบรรจุให้แน่นในแนวตั้ง กดด้วยแรง 30 N เป็นเวลา 15 s แล้วตรวจพินิจ

7.4 อัตราการไหลของน้ำเมื่อมีและเมื่อไม่มีตัวกรองอากาศ

7.4.1 ภาวะทดสอบ

ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ 27°C ± 2°C

7.4.2 เครื่องมือ

7.4.2.1 ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เกล็ดขนาด 1 000 cm³ พร้อมจุกยาง

7.4.2.2 กระจกตวง

7.4.2.3 เข็มฉีดยา ขนาดระบุ 21 G

7.4.2.4 นาฬิกาจับเวลา


7.4.3 วิธีทดสอบ

7.4.3.1 เติมน้ำกลั่นใส่ขวดแก้วจนถึงขีดปริมาตร ติดตั้งชุดทดสอบตามรูปที่ 4 ปรับตัวควบคุมการไหลให้อยู่ในภาวะปิด ส่วนปลายด้านข้อต่อในต่อกับเข็มฉีดยา ปรับระดับน้ำกลั่นให้อยู่สูงกว่าปลายเข็ม 1 m นำกระบอกตวงวางรองใต้ปลายเข็ม จากนั้นปรับตัวควบคุมการไหลให้เปิดเต็มที่ ปล่อยให้ น้ำกลั่น ไหลลงโดยอิสระ จับเวลาที่น้ำกลั่นไหลลงในกระบอกตวงจนครบ 500 cm³ แล้วคำนวณอัตราการไหลของน้ำกลั่นจากสูตร

$$v = \frac{500}{t}$$

เมื่อ v คือ อัตราการไหลของน้ำกลั่น เป็น cm³/min

t คือ เวลาที่น้ำกลั่นไหลผ่านชุดให้เลือดตัวอย่างจนครบ 500 cm³ เป็น min

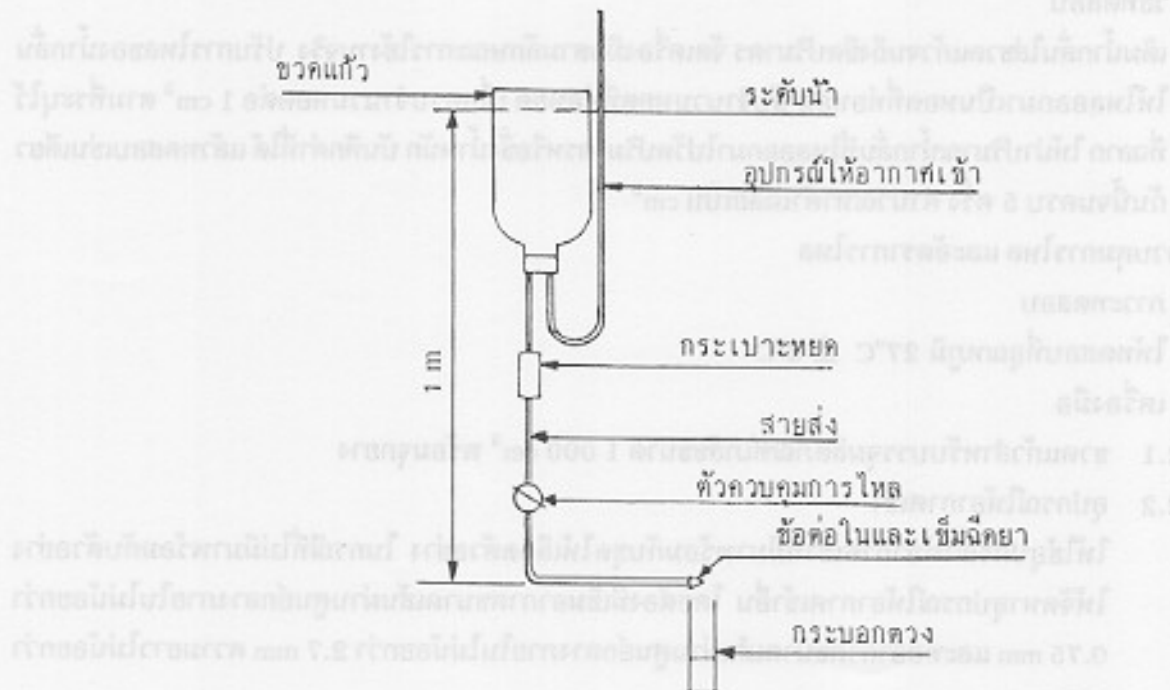

รูปที่ 4 การติดตั้งชุดทดสอบอัตราการไหลของน้ำเมื่อมีและเมื่อไม่มีตัวกรองอากาศ
ตัวควบคุมการไหล และอัตราการไหล

(ข้อ 7.4.3.1 ข้อ 7.6.3.1 และข้อ 7.6.3.2)

ให้ลองพิจารณากรณีอื่น ๆ ให้ดูรายละเอียดจากข้อ 7.6.3.1 และข้อ 7.6.3.2

ข้อ 7.4.3.2 ปฏิบัติตามข้อ 7.4.3.1 อีกครั้งหนึ่งโดยนำตัวกรองอากาศออกจากอุปกรณ์ให้อากาศเข้า

7.4.4 การรายงานผล

7.4.4.1 รายงานอัตราการไหลเมื่อมีตัวกรองอากาศเทียบกับเมื่อไม่มีตัวกรองอากาศ เป็น % (2)

7.5 ปริมาณน้ำกลับที่ไหลผ่านท่อหยด

7.5.1 ภาวะทดสอบ

ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ $27^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

7.5.2 เครื่องมือ

7.5.2.1 ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัช ขนาด $1\ 000\ \text{cm}^3$ พร้อมจุกยาง

7.5.2.2 อุปกรณ์ให้อากาศเข้า

ให้ใช้อุปกรณ์ให้อากาศเข้าที่มีมาพร้อมกับชุดให้เลือดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่มาพร้อมกับตัวอย่าง ให้จัดหาอุปกรณ์ให้อากาศเข้าอื่นแทน โดยต้องมีเข็มอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ไม่น้อยกว่า $0.75\ \text{mm}$ และท่ออากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ไม่น้อยกว่า $2.7\ \text{mm}$ ความยาวไม่น้อยกว่า $250\ \text{mm}$

7.5.3 วิธีทดสอบ

เติมน้ำกลั่นใส่ขวดแก้วจนถึงขีดปริมาตร จัดเครื่องมือตามลักษณะการใช้งานจริง ปรับการไหลของน้ำกลั่นให้ไหลออกมาเป็นหยดที่ต่อหยด นับจำนวนหยดที่ต่อหยด เมื่อครบจำนวนหยดต่อ 1 cm^3 ตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก ให้นำปริมาณน้ำกลั่นที่ไหลออกมาไปวัดปริมาตรหรือชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าที่ได้ แล้วทดสอบเช่นเดียวกันนี้จนครบ 5 ครั้ง คำนวณหาค่าเฉลี่ยเป็น cm^3

7.6 ตัวควบคุมการไหล และอัตราการไหล

7.6.1 ภาวะทดสอบ

ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ $27^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$

7.6.2 เครื่องมือ

7.6.2.1 ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เกล็ดขนาด $1\ 000 \text{ cm}^3$ พร้อมจุกยาง

7.6.2.2 อุปกรณ์ให้อากาศเข้า

ให้ใช้อุปกรณ์ให้อากาศเข้าที่มีมาพร้อมกับชุดให้เลือดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่มีมาพร้อมกับตัวอย่าง ให้จัดหาอุปกรณ์ให้อากาศเข้าอื่น โดยต้องมีเข็มอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 0.75 mm และท่ออากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2.7 mm ความยาวไม่น้อยกว่า 250 mm

7.6.2.3 กระบอกตวง

7.6.2.4 นาฬิกาจับเวลา

7.6.3 วิธีทดสอบ

7.6.3.1 ตัวควบคุมการไหล

- (1) เติมน้ำกลั่นใส่ขวดแก้วจนถึงขีดปริมาตร ติดตั้งชุดทดสอบตามรูปที่ 4 ปรับอัตราการไหลให้น้ำกลั่นไหลในอัตรา 15 หยดต่อ 1 min ถึง 20 หยดต่อ 1 min ทำเครื่องหมายบนสายส่งที่ตำแหน่งหัวและท้ายของตัวควบคุมการไหล
- (2) ปิดและเปิดตัวควบคุมการไหลจำนวน 15 รอบ แล้วปิดให้สนิทเป็นเวลา 30 min เลื่อนตัวควบคุมการไหล ตรวจสอบสภาพสายส่งตรงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ แล้วปรับอัตราการไหลให้เท่ากับครั้งแรก โดยเปลี่ยนตำแหน่งตัวควบคุมการไหลหรือไม่ก็ได้ ทำเช่นเดียวกันนี้จนครบ 3 ครั้ง ตรวจสอบสภาพสายส่งตรงตำแหน่งตัวควบคุมการไหล
- (3) ปรับอัตราการไหลให้น้ำกลั่นไหลในอัตรา 15 หยดต่อ 1 min ถึง 20 หยดต่อ 1 min ปลอ่ยให้น้ำกลั่นไหลด้วยอัตราดังกล่าว จนครบ $3\ 000 \text{ cm}^3$ โดยเมื่อน้ำกลั่น $1\ 000 \text{ cm}^3$ ไหลหมด ให้เปลี่ยนขวดน้ำกลั่นและปรับอัตราการไหลใหม่ เมื่อครบ $3\ 000 \text{ cm}^3$ ปิดตัวควบคุมการไหล แล้วตรวจสอบสภาพสายส่งตรงตำแหน่งตัวควบคุมการไหล

7.6.3.2 อัตราการไหล

เติมน้ำกลั่นใส่ขวดแก้วจนถึงขีดปริมาตร ติดตั้งชุดทดสอบตามรูปที่ 4 ปิดเข็มแทงเข้าเส้นเลือดหรือ ปลอกหุ้มข้อต่อในออกแล้ว ปรับตัวควบคุมการไหลให้อยู่ในภาวะปิด ปรับระดับน้ำกลั่นให้อยู่สูงกว่าปลายข้อต่อในที่วางอยู่ในแนวระดับ 1 m นำกระบอกตวงวางรองใต้ปลายเข็ม จากนั้นปรับตัวควบคุมการไหลให้เปิดเต็มที่ ปล่อยให้ น้ำกลั่นไหลลงโดยอิสระ จับเวลาที่น้ำกลั่นไหลลงในกระบอกตวงจนครบ 500 cm^3

7.7 บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑ์เภสัช (เฉพาะกรณีที่ใช้แทงด้วยเข็มฉีดยา)

7.7.1 เครื่องมือ

7.7.1.1 เข็มฉีดยา ขนาดระบุ 23 G

7.7.1.2 เครื่องอัดอากาศที่สามารถอัดอากาศให้ได้ความดันไม่น้อยกว่า 20 kPa


7.7.2 วิธีทดสอบ

บรรจุน้ำกลั่นจนเต็มชุดให้เลือดตัวอย่าง โดยไม่ให้เกิดฟองอากาศ แล้ววางบนโต๊ะ จัดให้บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑ์เภสัชอยู่ในแนวระนาบ ปิดปลายด้านข้อต่อในให้สนิท อัดอากาศเข้าทางเข็มฉีดยาจนบรรจุด้วยความดัน 20 kPa แทะเข็มฉีดยาที่บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑ์เภสัชที่เป็นยางของชุดให้เลือดตัวอย่าง แล้วคาไว้เป็นเวลา 15 s จึงดึงเข็มออก ขับบริเวณนั้นให้แห้งสนิททันที แล้วสังเกตการรั่วซึมตรงบริเวณที่แทงเข็มฉีดยาภายในเวลา 1 min

7.8 ข้อต่อใน

7.8.1 เครื่องมือ

7.8.1.1 เครื่องมือวัดรูปกรวย ความเร็ว 0.06 : 1 มีมิติดังรูปที่ 5

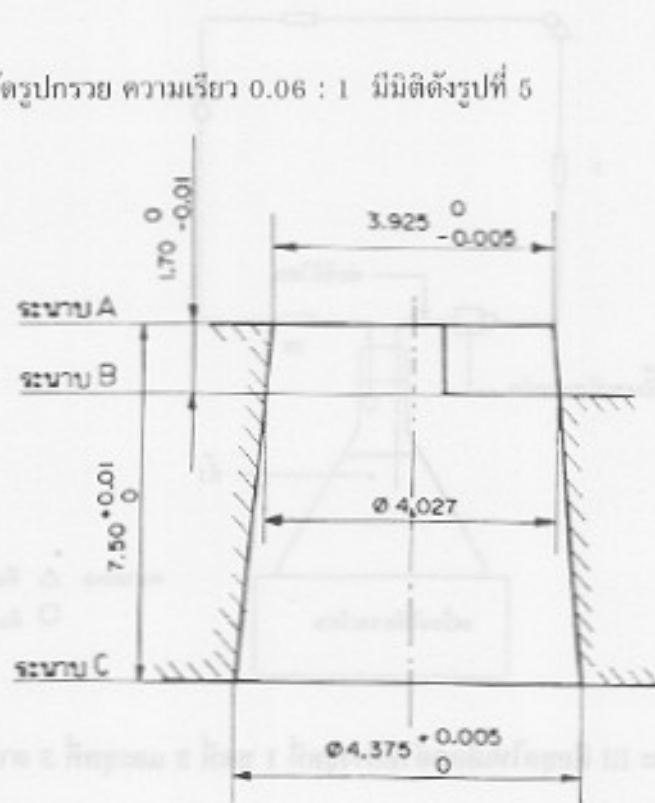

หน่วยเป็น mm

รูปที่ 5 มิติเครื่องมือวัดรูปกรวย ความเร็ว 0.06 : 1

(ข้อ 7.8.1.1)

7.8.2 วิธีทดสอบ

สวมข้อต่อในของชุดให้เลือดตัวอย่างเข้ากับเครื่องมือวัดรูปกรวยด้วยแรงในแนวแกน 5 N โดยไม่ต้องบิด แล้วตรวจตำแหน่งของด้านปลายเล็กของข้อต่อใน

7.9 คุณสมบัติทางเคมี

7.9.1 การเตรียมสารละลายที่สกัดได้และสารละลายแบลงก์

7.9.1.1 เครื่องมือ


- (1) ขวดแก้วบอโรซิลิเกต ขนาด 300 cm³
- (2) ปัมเปอร์ริสแทลติก (peristaltic pump) หรือปัมป์อื่นที่เทียบเท่า
- (3) ท่อซิลิโคน
- (4) เครื่องให้ความร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 37°C ± 1°C

7.9.1.2 สารละลาย

น้ำชั้นคุณภาพ 1 หรือชั้นคุณภาพ 2 ตาม มอก. 1287

7.9.1.3 วิธีเตรียมสารละลายที่สกัดได้

(1) ใส่ น้ำ 250 cm³ ในขวดแก้วบอโรซิลิเกตแล้วต่อขวดแก้ว ท่อซิลิโคน ปัมเปอร์ริสแทลติก และชุดให้เลือดตัวอย่าง 3 ชุด เพื่อให้เป็นระบบปิด ดังรูปที่ 6 โดยใช้ท่อซิลิโคนสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

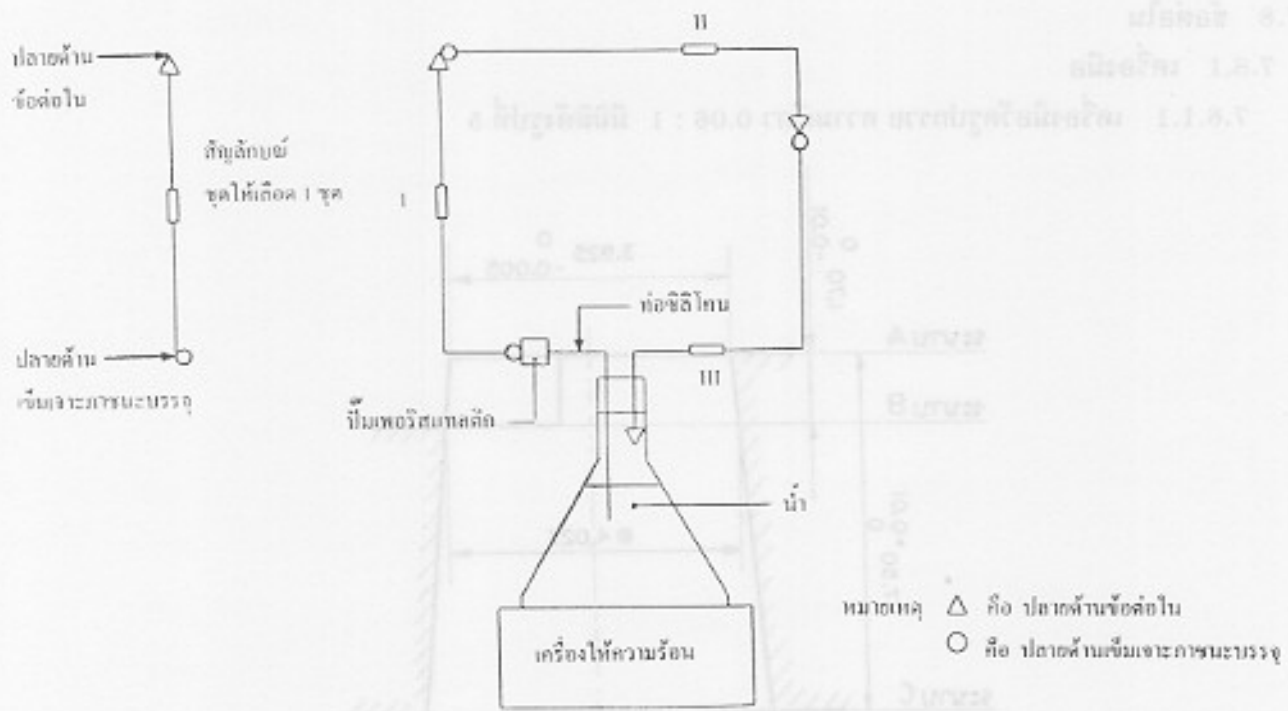

I II และ III คือชุดให้เลือดตัวอย่างชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ตามลำดับ

รูปที่ 6 เครื่องมือสำหรับเตรียมสารละลายที่สกัดได้และสารละลายแบลงก์

(ข้อ 7.9.1.3 (1))

- (2) ความคมอุทกภูมิของน้ำในขวดแก้วบอโรซิลิเกตไว้ที่ $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ตลอดการทดสอบ
- (3) ปลอ่ยให้น้ำไหลเวียนในระบบด้วยอัตราการไหล 1 l/h เป็นเวลา 2 h โดยเริ่มจากขวดแก้วไปที่ปั๊มเพอร์ริสเทติก ผ่านชุดให้เลือดตัวอย่างที่ต่อกันทั้ง 3 ชุด แล้วกลับสู่ขวดแก้วบอโรซิลิเกต
- (4) เก็บสารละลายที่สกัดได้ทั้งหมดในระบบไว้ในขวดแก้วบอโรซิลิเกต แล้วปลอ่ยให้เย็นลงจนถึงอุทกภูมิห้อง

7.9.1.4 วิธีเตรียมสารละลายแบบลงก์

ปฏิบัติตามข้อ 7.9.1.3 อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องผ่านชุดให้เลือดตัวอย่าง

7.9.2 วิธีทดสอบ

7.9.2.1 ลักษณะทั่วไป

ตรวจพินิจสารละลายที่สกัดได้

7.9.2.2 สารรีตีวซ์

(1) เครื่องมือ

ขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 100 cm^3 พร้อมจุกยาง

(2) สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม

(2.1) สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 0.002 mol/l

ละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 31.6 mg ด้วยน้ำกลั่นเล็กน้อยในขวดแก้ว

ปริมาตรขนาด 100 cm^3 เติมน้ำกลั่นจนถึงขีดปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วเก็บ

สารละลายที่ได้ในขวดสีชา

(2.2) สารละลายกรดซัลฟิวริก 1 mol/l

โพแทสเซียมไอโอไดด์

(2.4) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.005 mol/l

ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 1.3 g และโซเดียมคาร์บอเนต 10 mg ด้วยน้ำกลั่นที่ต้ม

เดือดใหม่และปลอ่ยไว้ให้เย็นแล้วปริมาตรเล็กน้อยในขวดแก้วปริมาตรขนาด $1\ 000$

cm^3 เติมน้ำกลั่นที่ต้มเดือดใหม่และปลอ่ยไว้ให้เย็นแล้วจนถึงขีดปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน

(2.5) น้ำแป้ง ที่เตรียมใหม่

ละลายแป้ง 1 g ด้วยน้ำกลั่น 10 cm^3 แล้วเทลงในน้ำเดือด 200 cm^3 อย่างช้า ๆ

พร้อมกับคนอย่างสม่ำเสมอ ต้มให้เดือดจนกระทั่งสารละลายมีลักษณะโปร่งแสง ตั้งทิ้ง

ไว้ให้ตกตะกอน เก็บสารละลายส่วนใสไว้

(3) วิธีวิเคราะห์

(3.1) ไซปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้ ที่เตรียมไว้ไม่เกิน 4 h 10 cm^3 ใส่ในขวดแก้วรูปกรวย

เติมสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 10 cm^3 และสารละลายกรดซัลฟิวริก 1

cm^3 ปิดจุก เขย่า ปลอ่ยไว้ที่อุทกภูมิห้องเป็นเวลา 15 min จากนั้นเติมโพแทสเซียม

ไอโอไดด์ 0.1 g แล้วไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต จนถึงจุด

ยุติเมื่อสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน เติมน้ำแป้ง 5 หยด แล้วไทเทรตต่อ

จนสีน้ำเงินจางหายไป บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต

ขยลลลลลลล (3.2) ปฏิบัติตามข้อ (3.1) อีกครั้งหนึ่งโดยใช้สารละลายแบลลงก์ 10 cm³ แทนสารละลาย
 ที่สกัดได้
 (3.3) การคำนวณ คำนวณหาปริมาณของสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา ได้จาก
 ผลต่างระหว่างการไทเทรตข้อ (3.1) กับข้อ (3.2)

7.9.2.3 ปริมาณโลหะ

- (1) การหาปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก และแคดเมียม
 นำสารละลายที่สกัดได้มาวิเคราะห์ปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก และ
 แคดเมียม โดยใช้อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่เทียบเท่า
- (2) การหาปริมาณโลหะ (เทียบเป็นตะกั่ว)
 - (2.1) เครื่องมือ
 หลอดเนสส์เลอร์ จำนวน 2 หลอด
 - (2.2) สารละลายและวิธีเตรียม
 - (2.2.1) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 10 µg/cm³ ที่เตรียมใหม่
 - (2.2.2) สารละลายโซเดียมซัลไฟด์
 ละลายโซเดียมซัลไฟด์ 5 g ในสารละลายผสมของน้ำกลั่น 10 cm³ กับ
 กลีเซอริน 30 cm³ เก็บสารละลายที่ได้ในขวดที่กันแสงได้
 - (2.3) วิธีวิเคราะห์
 - (2.3.1) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้ 10 cm³ ใส่ในหลอดเนสส์เลอร์ หลอดที่
 1 แล้วเติมน้ำกลั่นจนปริมาตรเป็น 50 cm³ ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลาย
 มาตรฐานตะกั่ว 1 cm³ ใส่ในหลอดเนสส์เลอร์หลอดที่ 2 แล้วเติมน้ำกลั่น
 จนปริมาตรเป็น 50 cm³
 - (2.3.2) เติมน้ำกลั่นและสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ 1 หยด ลงในหลอดเนสส์เลอร์ทั้ง 2 หลอด
 ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 5 min เปรียบเทียบสีของสารละลายในหลอดเนสส์เลอร์
 ทั้ง 2 หลอด บนพื้นสีขาวโดยมองลงในแนวตั้ง สีของสารละลายที่สกัดได้
 ในหลอดเนสส์เลอร์หลอดที่ 1 ต้องไม่เข้มกว่าสีของสารละลายมาตรฐาน
 ตะกั่วในหลอดเนสส์เลอร์หลอดที่ 2 จึงจะถือว่าตัวอย่างมีโลหะ (เทียบเป็น
 ตะกั่ว) ไม่เกิน 1 µg ต่อสารละลายที่สกัดได้ 1 cm³

7.9.2.4 ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง

- (1) สารละลายและวิธีเตรียม
 - (1.1) สารละลายทาทโรอินดิเคเตอร์
 ละลายเมทิลเรด 0.2 g และเมทิลีนบลู 0.1 g ในเอทานอล 95% แล้วเจือจางด้วย
 เอทานอลจนปริมาตรเป็น 100 cm³
 - (1.2) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.01 mol/l
 - (1.3) สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.01 mol/l

(2) วิธีวิเคราะห์

ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้ 20 cm^3 ใส่ในขวดแก้วรูปกรวย เติมสารละลายทาสีโรอินดิเคเตอร์ 0.1 cm^3 ถ้าสีของสารละลายที่สกัดได้เปลี่ยนเป็นสีม่วง ให้ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์จนสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเทา ถ้าสีของสารละลายที่สกัดได้เปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกจนสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเทา บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.01 mol/l หรือสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.01 mol/l ที่ใช้ไทเทรต

7.9.2.5 ปริมาณกากที่ไม่ระเหย

(1) เครื่องมือ

- (1.1) เครื่องชั่งที่ละเอียดถึง 0.1 mg
- (1.2) ตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ $105^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$
- (1.3) คุชเชิล ทำจากควอตซ์หรือกระเบื้องเคลือบ ที่อบจนน้ำหนักคงที่แล้ว 2 ใบ
- (1.4) เครื่องอังไอน้ำ
- (1.5) เลสิกเคเตอร์

(2) วิธีวิเคราะห์

- (2.1) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้ 50 cm^3 ใส่ลงในคุชเชิลใบที่หนึ่ง และสารละลายแบบองค์ประกอบเท่ากัน ใส่ลงในคุชเชิลใบที่สอง นำไประเหยให้แห้งบนเครื่องอังไอน้ำ
- (2.2) อบคุชเชิลทั้ง 2 ใบ ในตู้อบที่อุณหภูมิ $105^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 1 h นำออกมาใส่ในเตสิกเคเตอร์ ปลอบไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง นำไปชั่งแล้วอบซ้ำเป็นเวลาครั้งละ 1 h จนได้น้ำหนักคงที่ ผลต่างของน้ำหนักกากในคุชเชิลใบที่หนึ่งและใบที่สองคือ ปริมาณกากที่ไม่ระเหย

7.9.2.6 การดูดกลืนแสง

(1) เครื่องมือ

- (1.1) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 250 nm ถึง 320 nm
- (1.2) แผ่นกรอง ขนาดรูเปิด $0.45 \mu\text{m}$

(2) วิธีวิเคราะห์

กรองสารละลายที่สกัดได้ผ่านแผ่นกรอง แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 250 nm ถึง 320 nm โดยเทียบกับสารละลายแบบองค์ประกอบ ทั้งนี้ให้วัดค่าการดูดกลืนแสงภายใน 5 h หลังจากกรองผ่านแผ่นกรองแล้ว

7.10 สารไพโรเจน

7.10.1 การเตรียมสารละลายทดสอบ

บรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ที่ปราศจากเชื้อและสารไพโรเจน ที่มีอุณหภูมิ 37°C ถึง 40°C ให้เต็มชุดให้เลือดตัวอย่าง จำนวน 10 ชุด ทิ้งไว้ประมาณ 1 h ที่อุณหภูมิห้อง แล้วปล่อยให้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ไหลออกมาด้วยอัตราเร็วไม่เกิน $10 \text{ cm}^3/\text{min}$ เก็บสารละลายที่ไหลออกมาชุดละ 40 cm^3 รวมกันเพื่อใช้เป็นสารละลายทดสอบ

7.10.2 วิธีทดสอบ

หระกษชชช (๕)

ให้ปฏิบัติตาม USP 25 หัวข้อ Pyrogen Test หรือ Bacterial Endotoxins Test

7.11 การทำลายเม็ดเลือด

7.11.1 เครื่องมือ

7.11.1.1 ตู้อบที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 70°C ± 2°C

7.11.1.2 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่มีความยาวคลื่น 540 nm

7.11.1.3 เครื่องหมุนเหวี่ยง

7.11.1.4 หม้อนิ่งอัด

7.11.1.5 ตู้เพาะเชื้อ (incubator) ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 37°C ± 1°C

7.11.2 สารเคมี สารละลาย และวิธีเตรียม

7.11.2.1 สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ที่ปราศจากเชื้อ

7.11.2.2 สารมาตรฐานอ้างอิงฮีโมโกลบิน (haemoglobin reference standard) 6 mg/cm³

7.11.2.3 สารละลายแตรบคิน (Drabkin solution)

ละลายโซเดียมโบคาร์บอเนต 1 g โพแทสเซียมไฮยาไนด์ 0.05 g และโพแทสเซียมเฟรริไซยาไนด์ 0.2 g ในน้ำกลั่น และเติมน้ำกลั่นจนปริมาตรเป็น 1 000 cm³

7.11.3 การเตรียมเลือดกระต่าย

เจาะเลือดกระต่ายอย่างน้อย 3 ตัว ผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น แอซิดซิเตรตเดกซ์โทรส (acid citrate dextrose, ACD) ซิทริกฟอสเฟตเดกซ์โทรส (citric phosphate dextrose, CPD) แยกเก็บในภาชนะเก็บเลือดของกระต่ายแต่ละตัวที่อุณหภูมิ 4°C ± 2°C และควรนำมาทำการทดสอบภายใน 96 h

7.11.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ

บรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด์ให้เต็มชุดให้เลือดตัวอย่างจำนวน 3 ชุด ปิดปลายทั้ง 2 ด้านให้สนิท นำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 70°C ± 2°C เป็นเวลา 24 h ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง นำสารละลายที่สกัดได้จากตัวอย่างทั้งหมดมารวมกันใช้เป็นสารละลายทดสอบ

7.11.5 วิธีทดสอบ

7.11.5.1 การเตรียมกราฟสอบเทียบ

(1) เตรียมสารละลายสอบเทียบ โดยใช้ปิเปตต์ดูดสารมาตรฐานอ้างอิงฮีโมโกลบิน 10 cm³ 5 cm³ 2 cm³ 1 cm³ และ 0.5 cm³ ใส่ลงในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 cm³ จำนวน 5 ใบ ตามลำดับ เจือจางด้วยสารละลายแตรบคินจนถึงขีดปริมาตร สารละลายที่ได้จะมีความเข้มข้น 0.6 mg/cm³ 0.3 mg/cm³ 0.12 mg/cm³ 0.06 mg/cm³ และ 0.03 mg/cm³ ตามลำดับ

(2) วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแต่ละความเข้มข้น โดยใช้สารละลายแตรบคินเป็นแบล็ก

(3) สร้างกราฟสอบเทียบระหว่างความเข้มข้นของฮีโมโกลบินมาตรฐาน เป็น mg/cm³ กับค่าการดูดกลืนแสง

7.11.5.2 การตรวจหาระดับพลาสมาฮีโมโกลบินในเลือด

- (1) นำเลือดกระต่ายในแต่ละภาชนะบรรจุ ตามข้อ 7.11.3 ปริมาตร 1 cm^3 แยกใส่ลงในหลอดหมุนเหวี่ยง และนำไปหมุนเหวี่ยงในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 700 G ถึง 800 G เป็นเวลา 15 min
- (2) ดูดส่วนใสด้านบน (พลาสมา) 100 mm^3 (μl) เติมลงในสารละลายแตรบดิน 5.0 cm^3 ตั้งทิ้งไว้ 15 min แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใช้สารละลายแตรบดินเป็นแบลนด์
- (3) นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาของเลือดกระต่ายแต่ละตัว เป็น mg/cm^3
- (4) ถ้าเลือดกระต่ายตัวใดมีปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาเกิน $1.0 \text{ mg}/\text{cm}^3$ จะไม่นำเลือดกระต่ายตัวนั้นมาใช้ในการทดสอบต่อไป และต้องใช้เลือดกระต่ายในการทดสอบ 3 ตัว

7.11.5.3 การเจือจางเลือด

- (1) นำเลือดกระต่ายแต่ละตัวที่ผ่านการทดสอบหาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาแล้ว 20 mm^3 เติมลงในสารละลายแตรบดิน 5.0 cm^3 ตั้งทิ้งไว้ 15 min
- (2) นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใช้สารละลายแตรบดินเป็นแบลนด์ นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบิน
- (3) เจือจางเลือดกระต่ายแต่ละตัวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ปราศจากเชื้อ ให้มีปริมาณฮีโมโกลบินอยู่ในช่วง $25.0 \text{ mg}/\text{cm}^3 \pm 2.5 \text{ mg}/\text{cm}^3$ เป็นค่าฮีโมโกลบินปรากฏ (haemoglobin present)

7.11.5.4 การทดสอบตัวอย่าง

- (1) นำเลือดกระต่ายที่ได้จากข้อ 7.11.5.3(3) มาตัวละ 5.0 cm^3 เติมสารละลายทดสอบ 4.0 cm^3 นำไปบ่มในตู้บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ $37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 4 h
- (2) นำไปหมุนเหวี่ยงในแนวระดับ ด้วยอัตราเร็ว 100 G ถึง 200 G เป็นเวลา 15 min
- (3) ดูดส่วนใสด้านบนออก ใส่ในหลอดหมุนเหวี่ยงหลอดใหม่ แล้วนำไปหมุนเหวี่ยงด้วยอัตราเร็ว 700 G ถึง 800 G เป็นเวลา 5 min แยกส่วนใสด้านบนเพื่อนำไปหาค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด

7.11.5.5 การหาค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด

- (1) นำส่วนใสจากข้อ 7.11.5.4(3) มา 1.0 cm^3 เติมลงในสารละลายแตรบดิน 3.0 cm^3 ตั้งทิ้งไว้ 15 min
- (2) นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใช้สารละลายแตรบดินเป็นแบลนด์ นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินเป็นค่าฮีโมโกลบินปลดปล่อย (haemoglobin released)
- (3) คำนวณค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือดจากสูตร

$$\text{ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด} = \frac{\text{ฮีโมโกลบินปลดปล่อย}}{\text{ฮีโมโกลบินปรากฏ}} \times 100$$

(4) ค่าเฉลี่ยของดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด และการเทียบหาระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด

(ข้อ 7.11.5.5(4))

ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด	ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
0 ถึงน้อยกว่า 2	ไม่มีการแตกตัว
2 ถึงน้อยกว่า 10	มีการแตกตัวเล็กน้อย
10 ถึงน้อยกว่า 20	มีการแตกตัวปานกลาง
20 ถึงน้อยกว่า 40	มีการแตกตัวอย่างเห็นได้ชัด
40 ขึ้นไป	มีการแตกตัวอย่างรุนแรง

ภาคผนวก ก.

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 6.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ชุดให้เลือดที่ทำจากวัสดุอย่างเดียวกัน มีส่วนประกอบเหมือนกัน และทำให้ปราศจากเชื้อในคราวเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สายส่ง ตัวกรองเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ป्लอกหุ้มเข็มเจาะภาชนะบรรจุ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
- ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1 นำไปตรวจสอบการบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก และลักษณะทั่วไปก่อน แล้วจึงทดสอบสายส่ง ป्लอกหุ้มเข็มเจาะภาชนะบรรจุ และตัวกรองเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดตามลำดับ
- ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2.6 ข้อ 3.2.7 ข้อ 3.2.13 ข้อ 4. และข้อ 5. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สายส่ง ตัวกรองเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ป्लอกหุ้มเข็มเจาะภาชนะบรรจุ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
(ข้อ ก.2.1)

ขนาดรุ่น ชุด	ขนาดตัวอย่าง ชุด	เลขจำนวนที่ยอมรับ
ไม่เกิน 35 000	13	0
35 001 ขึ้นไป	50	1

- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบอนุภาคปนเปื้อน
- ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 ชุด
- ก.2.2.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.1 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการรั่วซึม เข็มเจาะภาชนะบรรจุ ข้อต่อไน และความทนอุณหภูมิสูง
- ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบรายการละ 10 ชุด
- ก.2.3.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.2 ข้อ 3.2.4 ข้อ 3.2.12 และข้อ 3.2.14 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

- ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบรอยต่อเชื่อมภายในชุดให้เลือด ตัวควบคุมการไหล และ อัตราการไหล
 - ก.2.4.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 13 ชุด นำไปทดสอบอัตราการไหลและรอยต่อเชื่อมภายในชุดให้เลือดตามลำดับ จำนวน 10 ชุด และทดสอบตัวควบคุมการไหล จำนวน 3 ชุด
 - ก.2.4.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.3 ข้อ 3.2.9 และข้อ 3.2.10 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ก.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ให้อากาศเข้า (ถ้ามี) กระเปาะหยด และบริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑ์เภสัช (เฉพาะกรณีที่ใช้แทงด้วยเข็มฉีดยา)
 - ก.2.5.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 10 ชุด นำไปทดสอบกระเปาะหยดตามข้อ 3.2.8.3 บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑ์เภสัช และอุปกรณ์ให้อากาศเข้าก่อน แล้วจึงทดสอบกระเปาะหยดตามข้อ 3.2.8.1 และข้อ 3.2.8.2
 - ก.2.5.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.5 ข้อ 3.2.8 และข้อ 3.2.11 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ก.2.6 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี
 - ก.2.6.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ชุด
 - ก.2.6.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.3 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ก.2.7 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความปราศจากเชื้อ
 - ก.2.7.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ทดสอบ 10 ชุด และสำรองไว้เพื่อการทดสอบซ้ำ 10 ชุด
 - ก.2.7.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.4.1 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ก.2.8 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบสารไพโรเจน
 - ก.2.8.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 10 ชุด
 - ก.2.8.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.4.2 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - ก.2.9 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการทำลายเม็ดเลือดและความเป็นพิษ
 - ก.2.9.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 4 ชุด เพื่อใช้ทดสอบการทำลายเม็ดเลือด 3 ชุด และทดสอบความเป็นพิษ 1 ชุด
 - ก.2.9.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.4.3 และข้อ 3.4.4 จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.3 เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างชุดให้เลือดต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 ข้อ ก.2.4.2 ข้อ ก.2.5.2 ข้อ ก.2.6.2 ข้อ ก.2.7.2 ข้อ ก.2.8.2 และข้อ ก.2.9.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าชุดให้เลือกรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ภาคผนวก ข.

การทดสอบความเป็นพิษ

(ข้อ 3.4.4)

ข.1 การทดสอบความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง

ข.1.1 เครื่องมือ

ข.1.1.1 ตู้อบ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

ข.1.2 สารละลาย

ข.1.2.1 สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.9 % ที่ปราศจากเชื้อ

ข.1.3 การเตรียมสารละลายทดสอบและสารละลายแบล็ก

ข.1.3.1 บรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ให้เต็มชุดให้เลือดตัวอย่าง ปิดปลายทั้ง 2 ข้างให้สนิท นำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 24 h ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิระหว่าง 20°C ถึง 30°C และนำสารละลายที่สกัดได้มาทดสอบภายในเวลา 24 h

ข.1.3.2 ให้ใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์เป็นสารละลายแบล็ก

ข.1.4 วิธีทดสอบ

ข.1.4.1 แบ่งหนูทดสอบที่มีสุขภาพดีและไม่เคยใช้ทดสอบมาก่อน มีน้ำหนักระหว่าง 17 g ถึง 23 g จำนวน 10 ตัว ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว

ข.1.4.2 ฉีดสารละลายทดสอบ และสารละลายแบล็กเข้าทางเส้นเลือดดำของหนูทดสอบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลำดับ ตัวละ 1.0 cm^3 แล้วปล่อยไว้เป็นเวลา 48 h

ข.1.4.3 สังเกตอาการของหนูแต่ละกลุ่ม

ข.1.5 เกณฑ์ตัดสิน

ข.1.5.1 ถ้าหนูทดสอบกลุ่มที่ฉีดด้วยสารละลายทดสอบทั้ง 5 ตัว ไม่ตาย และตัวใดตัวหนึ่งไม่มีอาการป่วยมากกว่าที่ฉีดด้วยสารละลายแบล็ก ให้ถือว่าชุดให้เลือดตัวอย่างไม่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง

ข.1.5.2 ถ้าหนูทดสอบกลุ่มที่ฉีดด้วยสารละลายทดสอบแสดงอาการป่วยมากกว่า 1 ตัว หรือมีหนูทดสอบตัวใดตัวหนึ่งตาย ให้ทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยใช้หนูทดสอบที่มีสมบัติตามข้อ ข.1.4.1 แต่มีน้ำหนัก $20\text{ g} \pm 1\text{ g}$ กลุ่มละ 10 ตัว หนูทดสอบกลุ่มที่ฉีดด้วยสารละลายทดสอบทั้ง 10 ตัว ต้องไม่ตายและไม่แสดงอาการป่วย หรือแสดงอาการป่วยที่ไม่มากกว่าที่ฉีดด้วยสารละลายแบล็ก จึงจะถือว่าชุดให้เลือดตัวอย่างไม่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันต่อสัตว์ทดลอง

ข.2 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง (cytotoxicity testing)

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง ให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้วิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่าตามที่กำหนดใน ISO 10993-5 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดต่อไปนี้เป็นวิธีตัดสิน

ข.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

- ข.2.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ ตู้ลามินาร์แอร์ฟลอร์ ตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องนับเม็ดเลือด (haemocytometer)
- ข.2.1.2 อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ หม้อนึ่งอัด ตู้อบ
- ข.2.1.3 ถาดเลี้ยงเซลล์ขนาด 24 หลุม
- ข.2.1.4 ขวดแก้วฝาเกลียวสำหรับสกัดตัวอย่าง
- ข.2.1.5 ขวดเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ (tissue culture flask) ขนาดพื้นที่ 75 cm^2

ข.2.2 สารละลายและวิธีเตรียม

- ข.2.2.1 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ปราศจากเชื้อ
ละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 0.2 g โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.2 g โซเดียมคลอไรด์ 8.0 g และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส 1.15 g ในน้ำกลั่น และเติมน้ำกลั่นจนปริมาตรเป็น $1\ 000 \text{ cm}^3$ ทำให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอัดที่อุณหภูมิ $121^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 15 min หรือกรองผ่านแผ่นกรองขนาดรูเปิด $0.22 \mu\text{m}$
- ข.2.2.2 สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 100 g/l ที่ปราศจากเชื้อ
- ข.2.2.3 สารละลายทริปซิน (trypsin) 0.5 g/l ที่ปราศจากเชื้อ
- ข.2.2.4 สารละลายกลูตามีน (glutamine) 29.2 g/l ที่ปราศจากเชื้อ
- ข.2.2.5 อาหารเลี้ยงเซลล์อีเกิลส์เอ็มเอ็ม (Eagle's MEM)
- ข.2.2.6 อาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต และอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่าง
เติมสารละลายกลูตามีน 1 cm^3 สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 1.2 cm^3 และเซรุ่มฟิวส์โบวีน (fetal bovine serum) 5 cm^3 ลงในอาหารเลี้ยงเซลล์อีเกิลส์เอ็มเอ็ม 100 cm^3 โดยวิธีปราศจากเชื้อ เก็บไว้ในขวดแก้วฝาเกลียวที่อุณหภูมิ 2°C ถึง 8°C เก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์
- ข.2.2.7 สารละลายฟอรัลนิน-คริสตัลไวโอเลต (formalin-crystal violet)
ละลายคริสตัลไวโอเลต 500 mg ด้วยสารละลายฟอรัลนิน (BP) 10 cm^3 และสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 90 cm^3 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
- ข.2.2.8 สีย้อมทริปแพนบลู (trypan blue stain) 4.0 g/l
- ข.2.2.9 การควบคุมเชิงบวก
สารเคมีควบคุมเชิงบวก (positive chemical control) คือ สารละลายซิงก์แอสซีเทต 4 mg/l
วัสดุควบคุมเชิงบวก (positive material control) คือ แผ่นโพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีซิงก์ไดออกไซด์ไทเทเนียมคาร์บอเนต 0.1%
- ข.2.2.10 การควบคุมเชิงลบ
สารเคมีควบคุมเชิงลบ (negative chemical control) คือ สารละลายซิงก์แอสซีเทต 2 mg/l
วัสดุควบคุมเชิงลบ (negative material control) คือ พลาสติก เช่น โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน หรือแผ่นยาง ที่ปราศจากสารเติมแต่ง

ข.2.3 การเตรียมเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง

ข.2.3.1 การเตรียมสารแขวนลอยของเซลล์เนื้อเยื่อ (cell suspension)

นำเซลล์เนื้อเยื่อ L-929 (ATCC cell line CCL 1, NCTC clone 929) ที่เพาะเลี้ยงไว้ในขวดเพาะเลี้ยงเซลล์ ขนาดพื้นที่ 75 cm^2 มาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ เติมน้ำสารละลายทวีปซิน 1 cm^3 และอบในตู้อบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ $37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 3 min ถึง 5 min เคาะขวดเบา ๆ จนเซลล์หลุดร่อนจากพื้นผิวขวด แล้วจึงเติมอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต 3 cm^3 ถึง 5 cm^3 ลงในขวด เขย่าขวดให้ได้สารแขวนลอยของเซลล์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน นำสารแขวนลอยที่ได้นี้ไปวัดความเข้มข้นของเซลล์ โดยดูดสารแขวนลอยของเซลล์ 0.1 cm^3 มาผสมกับสีย้อมทริปแทนบลู 0.1 cm^3 ทิ้งไว้ 1 min แล้วนับจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตพร้อมทั้งคำนวณความเข้มข้นของเซลล์ในสารแขวนลอย โดยใช้เครื่องนับเม็ดเลือด เจือจางสารแขวนลอยของเซลล์นี้ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต ให้ได้ความเข้มข้น 3×10^5 เซลล์ต่อ 1 cm^3

ข.2.3.2 นำเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงที่มีความเข้มข้น 3×10^5 เซลล์ต่อ 1 cm^3 เติมน้ำลงในภาดเลี้ยงเซลล์ขนาด 24 หลุม หลุมละ 0.5 cm^3 แล้วนำไปอบในตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ $37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน จนเซลล์โตเป็นชั้นเดี่ยว (monolayer) อย่างน้อย 80% ของพื้นที่เลี้ยงเซลล์

ข.2.4 วิธีทดสอบ

ข.2.4.1 การเตรียมสารละลายทดสอบ และสารละลายควบคุม

(1) การเตรียมสารละลายทดสอบ

ตัดส่วนต่าง ๆ ของชุดให้เลือดตัวอย่างที่ล้างและนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งอัดแล้วใส่ลงในขวดแก้วฝาเกลียวสำหรับสกัดตัวอย่าง เติมน้ำอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่างปริมาตร $5 \text{ cm}^3/\text{g}$ และ $10 \text{ cm}^3/\text{g}$ ของชิ้นส่วนตัวอย่างที่เป็นพลาสติกและยางตามลำดับ นำไปอบในตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ $37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 24 h \pm 1 h เขย่าขวดเป็นระยะ สารละลายที่ได้เป็นสารละลายทดสอบ 100%

เตรียมสารละลายทดสอบ 66% 44% 30% และ 20% จากสารละลายทดสอบ 100% โดยเจือจางเป็นอนุกรม (serial dilution) ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดในอัตราส่วน

2 : 1 ตามลำดับ

(2) การเตรียมสารละลายควบคุม

(2.1) เตรียมสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวก และสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ โดยสกัดวัสดุควบคุมเชิงบวก และวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธีในข้อ ข.2.4.1(1)

(2.2) เตรียมสารเคมีควบคุมเชิงบวก และสารเคมีควบคุมเชิงลบ โดยเตรียมสารละลายซิงก์ แอซีเทตในอาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่าง ที่มีความเข้มข้น 4 mg/l และ 2 mg/l ตามลำดับ

ข.2.4.2 ตู้อาหารเลี้ยงเซลล์ในภาดเลี้ยงเซลล์แต่ละหลุมออก

ข.2.4.3 เติมสารละลายทดสอบความเข้มข้นต่าง ๆ และสารละลายควบคุม ดังต่อไปนี้ ลงสัมผัสกับเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง หลุมละ 0.5 cm³ โดยเติมชนิดละ 3 หลุม

- (1) สารละลายทดสอบ ความเข้มข้น 100% 66% 44% 30% และ 20% ตามลำดับ
- (2) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวก และ/หรือสารละลายซิงก์แอซีเทต 4 mg/l
- (3) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ และ/หรือสารละลายซิงก์แอซีเทต 2 mg/l
- (4) อาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับสกัดตัวอย่างเพื่อใช้เป็นแบล่งก์

ข.2.4.4 นำภาตเลี้ยงเซลล์ไปอบในตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 37°C ± 1°C เมื่อครบระยะเวลา 24 h และ 48 h ให้ประเมินผลตามวิธีในข้อ ข.2.5

ข.2.5 การประเมินผล

หลังจากปล่อยให้เซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงในภาตเลี้ยงเซลล์ สัมผัสกับสารละลายทดสอบ สารละลายควบคุม และแบล่งก์ เป็นเวลา 24 h และ 48 h แล้ว ดูความเป็นพิษที่เกิดกับเซลล์ โดยดูลักษณะของเซลล์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ บันทึกการตายของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (morphological change) และความหนาแน่นของเซลล์ที่มีชีวิต (cell density) แล้วประเมินผลตามตารางที่ ข.1

หลังจากบันทึกผลที่ 48 h แล้ว ให้ยัด (fix) และย้อมสีเซลล์ติดบนภาตเลี้ยงเซลล์ด้วยสารละลายฟอร์มาลิน-คริสทอลล์ไอโอเลต เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ

ตารางที่ ข.1 การประเมินระดับความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง

(ข้อ ข.2.5)

ระดับความเป็นพิษ	ปฏิกิริยา (reactivity)	สภาพของเซลล์เนื้อเยื่อ (conditions of cell culture)
0	ไม่เป็นพิษ (none toxic)	พบเซลล์แต่เป็นชั้นเดียว มีเม็ดอินทราไซโทพลาสซึม (intracytoplasmic granule) กระจายอยู่ในเซลล์ตามปกติ ไม่พบการแตกทำลายของเซลล์
1	เป็นพิษน้อยมาก (slightly toxic)	พบเซลล์มีลักษณะกลม ใกล้เคียงหลุดออกจากพื้นผิว ไม่เกิน 20% อาจพบการแตกทำลายของเซลล์ได้บ้าง
2	เป็นพิษน้อย (mild toxic)	พบเซลล์มีลักษณะกลม ไม่เกิน 50% อาจพบการแตกทำลายของเซลล์แต่ไม่รุนแรง และไม่พบช่องว่างระหว่างเซลล์ชั้นเดียว
3	เป็นพิษปานกลาง (moderate toxic)	พบเซลล์มีลักษณะกลมหรือพบการแตกทำลายของเซลล์ ไม่เกิน 70%
4	เป็นพิษอย่างรุนแรง (severely toxic)	พบการทำลายของเซลล์ชั้นเดียวเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมด

ข.2.6 การแปลผล

ข.2.6.1 การทดสอบจะมีผลเชื่อถือได้ต่อเมื่อ

- (1) แบลงก์ สารละลายซิงก์แอสซีเทต 2 mg/l และสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (ความเป็นพิษระดับ 0)
- (2) สารละลายซิงก์แอสซีเทต 4 mg/l และสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวกมีความเป็นพิษต่อเซลล์ระดับ 3 ขึ้นไป

ข.2.7 เกณฑ์ตัดสิน

ผลการทดสอบจะถือว่าตัวอย่างไม่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง เมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- (1) สารละลายทดสอบ 100% มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไม่มากกว่าระดับ 2
 - (2) สารละลายทดสอบ 44% มีความเป็นพิษต่อเซลล์ในระดับ 0
-

ใบแก้คำผิด

มอก. 720-2546 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว

หน้า -8- ข้อ 7.1.1 บรรทัดที่ 3 ให้แก้ไขจาก “ต่อ 1 cm³” เป็น “ต่อ 1 m³”

หน้า -15- ข้อ 7.9.2.2 บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขจาก “พร้อมจุกยาง” เป็น “พร้อมจุก”

หน้า -15- ข้อ 7.9.2.2(3.1) บรรทัดที่ 4 และ 5 ให้แก้ไขจาก “จนถึงจุดยุติเมื่อสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน” เป็น “จนถึงจุดยุติเมื่อสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน”

หน้า -25- ข้อ ข.2.3.1 บรรทัดที่ 3 ให้แก้ไขจาก “ขนาดพื้นที่ 75 cm³” เป็น “ขนาดพื้นที่ 75 cm²”

หน้า -25- ข้อ ข.2.4.1(1) บรรทัดที่ 3 และ 4 ให้แก้ไขจาก “cm³/g” เป็น “cm³ ต่อ 1 g”

พฤษภาคม 2547